

UNIVERSITATEA [NUMELE UNIVERSITĂȚII]

FACULTATEA DE CHIMIE

Programul de studii: Chimie

LUCRARE DE LICENȚĂ

Determinarea unor metale grele în apa potabilă prin spectrometrie de absorbție atomică

Plumb, cadmiu și nichel în probe din șase puncte ale unei rețele de distribuție

EXEMPLU FICTIV – structura, tabelele și figurile unei lucrări de licență. Datele sunt simulate.

Coordonator științific:

Conf. univ. dr. Radu Stănescu (nume fictiv)

Absolvent:

Ioana Marinescu (nume fictiv)

CLUJ-NAPOCA, 2026

DECLARAȚIE DE AUTENTICITATE

Subsemnatul(a) **Ioana Marinescu**, absolvent(ă) al(a) programului de studii Chimie, declar pe propria răspundere că lucrarea de licență cu titlul „Determinarea unor metale grele în apa potabilă prin spectrometrie de absorbție atomică” a fost elaborată de mine, sub îndrumarea coordonatorului științific, nu a mai fost prezentată la o altă facultate sau instituție de învățământ superior și că toate sursele folosite, inclusiv cele de pe internet, sunt citate în lucrare, cu respectarea regulilor privind drepturile de autor.

Data: [data]

Semnătura: [semnătura]

Majoritatea facultăților au un model oficial de declarație de autenticitate. Copiază-l exact din ghidul facultății și semnează-l; textul de aici este doar orientativ.
Sfat
20/05/2026 10:00

CUPRINS

Lista figurilor și a tabelelor.....	4
Rezumat.....	5
Introducere.....	6
Capitolul 1. Metalele grele în apa potabilă și metodele de determinare.....	7
1.1. Surse și efecte asupra sănătății.....	7
1.2. Valorile parametrice.....	7
1.3. Metode instrumentale de determinare.....	8
Capitolul 2. Partea experimentală.....	9
2.1. Reactivi și aparatură.....	9
2.2. Prelevarea probelor.....	9
2.3. Condiții instrumentale.....	10
Capitolul 3. Rezultate și discuții.....	11
3.1. Dreapta de etalonare.....	11
3.2. Validarea metodei.....	12
3.3. Concentrațiile metalelor în probe.....	12
3.4. Interpretarea rezultatelor.....	14
Concluzii.....	15
Bibliografie.....	16
Anexa 1. Procedura de lucru pentru determinarea plumbului.....	17
Bonus: același paragraf, înainte și după corectare.....	18

Cuprinsul arată din prima pagină logica lucrării: introducere, capitole teoretice, cercetarea proprie, concluzii. În Word îl generezi automat din stilurile de titlu (Referințe → Cuprins), ca să se actualizeze singur.

Ghid: licenta-disertatie-romania.co
 Rolul secțiunii
 20/05/2026 10:00

Lista figurilor și a tabelelor

Listele de figuri și tabele sunt cerute de multe facultăți. În Word le generezi automat dacă pui titlurile cu Referințe → Inserare legendă, apoi Referințe → Inserare tabel de figuri.
Ghid: licenta-disertatie-romania.co
Rolul secțiunii
20/05/2026 10:00

Lista figurilor

Figura 1. Sursele principale de metale grele în apa de la robinet.....	7
Figura 2. Principiul spectrometriei de absorbție atomică.....	8
Figura 3. Etapele procedurii experimentale.....	10
Figura 4. Dreapta de etalonare pentru plumb: absorbanta măsurată și cea calculată.....	11
Figura 5. Reziduurile drepte de etalonare pentru plumb.....	12
Figura 6. Concentrația de plumb în punctele de prelevare, comparată cu valoarea parametrică (μg/L).....	13
Figura 7. Concentrațiile exprimate ca procent din valoarea parametrică.....	14

Lista tabelelor

Tabelul 1. Valorile parametrice pentru metalele studiate în apa destinată consumului uman...	7
Tabelul 2. Metode instrumentale pentru determinarea metalelor grele în apă.....	8
Tabelul 3. Reactivii și aparatura folosite.....	9
Tabelul 4. Punctele de prelevare a probelor (localizare generică).....	9
Tabelul 5. Condițiile instrumentale pentru determinarea prin GFAAS.....	10
Tabelul 6. Datele de etalonare pentru plumb.....	11
Tabelul 7. Parametrii de validare a metodei.....	12
Tabelul 8. Absorbanta și concentrația de plumb în probe (media a trei determinări).....	13
Tabelul 9. Concentrațiile celor trei metale comparate cu valorile parametrice (μg/L).....	13

Rezumat

Rezumatul are de obicei 150–300 de cuvinte și spune pe scurt tema, obiectivul, metoda, rezultatele și concluzia. Multe facultăți îl cer și în limba engleză, cu 3–5 cuvinte-cheie.
Rolul secțiunii
20/05/2026 10:00

Lucrarea determină concentrațiile de plumb, cadmiu și nichel în apa potabilă prin spectrometrie de absorbție atomică cu atomizare în cuptor de grafit (GFAAS). Probele au fost prelevate din șase puncte ale unei rețele de distribuție, de la ieșirea din stația de tratare până la robinetul unor clădiri cu instalații vechi. Metoda a fost validată: dreapta de etalonare pentru plumb este liniară între 0 și 25 $\mu\text{g/L}$ ($R^2 = 0,9996$), limitele de cuantificare sunt mult sub valorile parametrice, repetabilitatea este sub 4%, iar recuperarea este între 96,0% și 101,2%. Cadmiul și nichelul se află sub valorile parametrice în toate punctele. Plumbul crește de la 2,02 $\mu\text{g/L}$ la stația de tratare la 11,77 $\mu\text{g/L}$ într-o clădire veche, singura probă neconformă. Rezultatele indică instalațiile interioare ca sursă principală a plumbului. Toate datele sunt simulate pentru exemplu.

Cuvinte-cheie: metale grele, apă potabilă, spectrometrie de absorbție atomică, GFAAS, validarea metodei, plumb

Abstract

This thesis determines lead, cadmium and nickel concentrations in drinking water by graphite furnace atomic absorption spectrometry (GFAAS). Samples were collected from six points of a distribution network, from the outlet of the treatment plant to the taps of buildings with old plumbing. The method was validated: the lead calibration line is linear between 0 and 25 $\mu\text{g/L}$ ($R^2 = 0.9996$), the limits of quantification are well below the parametric values, repeatability is below 4% and recovery ranges from 96.0% to 101.2%. Cadmium and nickel are below the parametric values at all points. Lead rises from 2.02 $\mu\text{g/L}$ at the treatment plant to 11.77 $\mu\text{g/L}$ in an old building, the only non-compliant sample. The results point to indoor plumbing as the main source of lead. All data are simulated for this example.

Keywords: heavy metals, drinking water, atomic absorption spectrometry, GFAAS, method validation, lead

Introducere

Plumbul, cadmiul și nichelul pot ajunge în apa de la robinet din surse naturale, din poluarea industrială sau din instalațiile de distribuție. Chiar și în concentrații de ordinul $\mu\text{g/L}$, expunerea de durată are efecte asupra sănătății, de aceea legislația europeană stabilește valori parametrice stricte pentru aceste metale [1].

Lucrarea determină concentrațiile de Pb, Cd și Ni în probe de apă potabilă prelevate din șase puncte ale unei rețele de distribuție, prin spectrometrie de absorbție atomică cu atomizare în cuptor de grafit (GFAAS).

Obiectivele lucrării sunt:

1. stabilirea și verificarea dreptei de etalonare pentru fiecare metal;
2. validarea metodei: limita de detecție (LOD), limita de cuantificare (LOQ), repetabilitatea și recuperarea;
3. determinarea concentrațiilor în probe și compararea lor cu valorile parametrice.

Introducerea la Chimie prezintă contextul (de ce contează tema), stadiul cercetării pe scurt, obiectivele și structura lucrării. Nu descrie aici rezultatele.

Ghid: licenta-disertatie-romania.co
Rolul secțiunii
20/05/2026 10:00

Obiectivele trebuie să fie verificabile: fiecare are, în Capitolul 3, un tabel sau o figură care arată dacă a fost atins.

Ghid: licenta-disertatie-romania.co
Sfat
20/05/2026 10:00

Capitolul 1. Metalele grele în apa potabilă și metodele de determinare

1.1. Surse și efecte asupra sănătății

Metalele grele din apa de la robinet au două origini principale: sursa de apă (roci, soluri, ape uzate) și sistemul de distribuție, în special instalațiile interioare vechi și fittingurile din alamă [3], [5] (Figura 1).




Figura 1. Sursele principale de metale grele în apa de la robinet
Sursa: Prelucrare proprie.

1.2. Valorile parametrice

Directiva (UE) 2020/2184 stabilește valori parametrice pentru metalele din apa destinată consumului uman (Tabelul 1). Pentru plumb, valoarea de 10 µg/L se aplică până la 12 ianuarie 2036, după care scade la 5 µg/L [1].

Tabelul 1. Valorile parametrice pentru metalele studiate în apa destinată consumului uman

Metal	Valoare parametrică	Observații	Efecte principale asupra sănătății
Plumb (Pb)	10 µg/L	Valoarea scade la 5 µg/L, cel târziu de la 12 ianuarie 2036	Neurotoxic, în special pentru copii
Cadmiu (Cd)	5,0 µg/L	–	Se acumulează în rinichi
Nichel (Ni)	20 µg/L	–	Sensibilizant (alergii de contact)
Cupru (Cu)	2,0 mg/L	Nu a fost determinat în lucrare	Tulburări digestive la concentrații mari

Sursa: Directiva (UE) 2020/2184, anexa I, partea B [1]; efectele sunt sintetizate după [3].

Capitolul de literatură arată ce se știe deja: de unde provin contaminanții, ce limite impune legislația și ce metode analitice există. Fiecare afirmație are o trimitere numerică [n], în stil ACS.
Ghid: licenta-disertatie-romania.co
Rolul secțiunii
20/05/2026 10:00

Valorile-limită se citează din actul normativ în vigoare la data redactării, cu articolul sau anexa exactă. În România, directiva se aplică prin legislația națională privind calitatea apei potabile (Legea nr. 458/2002, cu modificările ulterioare [6]): verifică forma actualizată a legii și dacă valorile naționale coincid cu cele din tabel. Greșeală frecventă
20/05/2026 10:00

1.3. Metode instrumentale de determinare

Alegerea metodei depinde de concentrația așteptată și de aparatura disponibilă (Tabelul 2). Pentru Pb și Cd în apa potabilă, AAS cu flacără nu este suficient de sensibilă, de aceea se folosește atomizarea în cuptor de grafit [2], [4].

Tabelul 2. Metode instrumentale pentru determinarea metalelor grele în apă

Metoda	Ordinul de mărime al limitei de detecție	Avantaje	Limite
AAS cu flacără (FAAS)	mg/L	Rapidă, ieftină, ușor de folosit	Prea puțin sensibilă pentru Pb și Cd în apa potabilă
AAS cu cuptor de grafit (GFAAS)	μg/L	Sensibilă, volum mic de probă	Un singur element pe rând, timp mai lung de analiză
ICP-OES	μg/L	Multielement	Cost ridicat, interferențe spectrale
ICP-MS	ng/L	Cea mai sensibilă, multielement	Aparatură scumpă, personal specializat

Sursa: Sinteză proprie după [2], [4].

În AAS, atomii liberi ai elementului absorb radiația caracteristică emisă de o lampă cu catod cavită (Figura 2). Absorbanța este proporțională cu concentrația, în domeniul liniar al metodei [2]:

$$A = \lg(I_0 / I) = k \cdot c \quad (1.1)$$




Figura 2. Principiul spectrometriei de absorbție atomică

Sursa: Prelucrare proprie.

Capitolul 2. Partea experimentală

Partea experimentală descrie materialele, aparatura și procedura atât de precis încât altcineva să poată repeta experimentul: puritatea reactivilor, furnizorul, condițiile de lucru, numărul de replicate.
Rolul secțiunii
20/05/2026 10:00

2.1. Reactivi și aparatură

Reactivii și aparatura sunt prezentate în Tabelul 3. Toate vasele au fost spălate cu HNO_3 10% și clătite cu apă ultrapură, pentru a evita contaminarea.

Tabelul 3. Reactivii și aparatura folosite

Reactiv / aparat	Specificație	Utilizare
Acid azotic (HNO_3) 65%	Puritate pentru analiza urmelor	Acidularea probelor ($\text{pH} < 2$) și diluții
Soluții etalon Pb, Cd, Ni	1000 mg/L, certificate	Prepararea soluțiilor de etalonare
Modificator de matrice	Pd + $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$	Stabilizarea analitului în etapa de piroliză
Apă ultrapură	Rezistivitate 18,2 $\text{M}\Omega \cdot \text{cm}$	Diluții, probe blanc
Spectrometru AAS	Cuptor de grafit, corecție Zeeman (model generic)	Măsurarea absorbanței

Sursa: Laboratorul de chimie analitică al facultății (descriere generică)

La Chimie, substanțele periculoase se menționează cu frazele de pericol (H) din fișa cu date de securitate (FDS) a furnizorului. Copiază-le din FDS-ul reactivului pe care l-ai folosit, nu din alte lucrări.
Sfat
20/05/2026 10:00

2.2. Prelevarea probelor

Au fost prelevate probe din șase puncte, de la ieșirea din stația de tratare până la robinetul consumatorului (Tabelul 4). În fiecare punct apa a curs 2 minute înainte de prelevare. Etapele de lucru sunt rezumate în Figura 3.

Tabelul 4. Punctele de prelevare a probelor (localizare generică)

Cod	Punctul de prelevare	Tipul instalației	Data
P1	Ieșirea din stația de tratare	Conductă de oțel, nouă	03.03.2026
P2	Rețea, cartier rezidențial	Conducte PEHD	03.03.2026
P3	Rețea, clădire publică	Conducte PEHD	04.03.2026
P4	Bloc de locuințe construit înainte de 1980	Instalație interioară din oțel zincat	04.03.2026
P5	Clădire veche, centrul orașului	Instalație interioară cu porțiuni din plumb (presupuse)	05.03.2026
P6	Capăt de rețea, zonă periurbană	Conducte PEHD	05.03.2026

Sursa: Puncte de prelevare fictive, construite pentru exemplu.

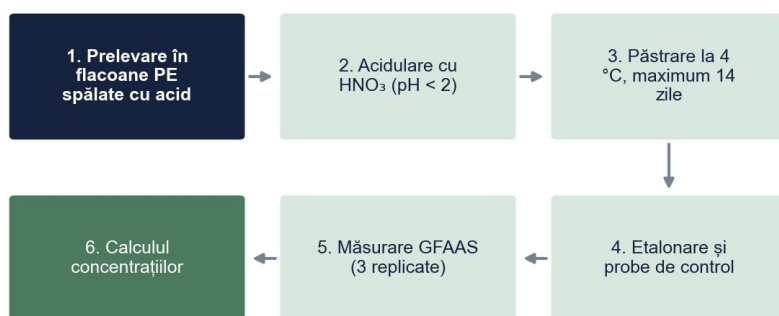


Figura 3. Etapele procedurii experimentale

Sursa: Prelucrare proprie.

2.3. Condiții instrumentale

Determinările s-au făcut cu un spectrometru AAS cu cuptor de grafit și corecție de fond Zeeman, în condițiile din Tabelul 5. Fiecare probă a fost măsurată în trei replicare.

Tabelul 5. Condițiile instrumentale pentru determinarea prin GFAAS

Parametrul	Pb	Cd	Ni
Lungimea de undă (nm)	283,3	228,8	232,0
Lărgimea fantei (nm)	0,7	0,7	0,2
Temperatura de piroliză (°C)	850	700	1100
Temperatura de atomizare (°C)	1600	1500	2300
Volumul de probă injectat (μL)	20	20	20

Notă. Temperaturile sunt orientative; în lucrarea ta copiază programul de temperatură optimizat pe aparatul tău.

Sursa: Programul de lucru al aparatului (valori de exemplu).

Capitolul 3. Rezultate și discuții

Acesta este capitolul cu contribuția ta: datele proprii, calculele, validarea și interpretarea lor. Fiecare tabel este urmat de o propoziție care spune ce arată, iar capitolul se încheie cu interpretarea ta, comparată cu literatura.
Rolul secțiunii
20/05/2026 10:00

3.1. Dreapta de etalonare

Pentru plumb s-au folosit șase soluții etalon, între 0 și 25 µg/L (Tabelul 6). Prin regresie liniară s-a obținut ecuația:

$$A = 0,00837 \cdot c + 0,0029, \quad R^2 = 0,9996 \quad (3.1)$$

unde A este absorbanta, iar c concentrația de plumb în µg/L. Punctele măsurate se suprapun aproape perfect peste valorile calculate (Figura 4), iar reziduurile nu depășesc 0,0023 unități de absorbantă și nu au o tendință sistematică.

Tabelul 6. Datele de etalonare pentru plumb

c Pb (µg/L)	Absorbanța măsurată	Absorbanța calculată	Reziduul
0	0,0031	0,0029	0,0002
5	0,0437	0,0447	-0,0010
10	0,0876	0,0865	0,0011
15	0,1270	0,1284	-0,0014
20	0,1725	0,1702	0,0023
25	0,2108	0,2120	-0,0012

Notă. Absorbanța calculată provine din ecuația dreptei de etalonare (ec. 3.1); reziduul este diferența dintre valoarea măsurată și cea calculată.
Sursa: Date experimentale simulate pentru exemplu.




Figura 4. Dreapta de etalonare pentru plumb: absorbanta măsurată și cea calculată

Sursa: Prelucrare proprie.

Reziduurile alternează ca semn și nu cresc odată cu concentrația (Figura 5), deci modelul liniar este adecvat în tot domeniul de lucru.




Figura 5. Reziduurile dreptei de etalonare pentru plumb

Sursa: Prelucrare proprie

Un R^2 apropiat de 1 nu dovedește singur liniaritatea. Prezintă și reziduurile: dacă ele cresc sau formează o curbă, domeniul de lucru este prea larg.
Greșeală frecventă
20/05/2026 10:00

3.2. Validarea metodei

Limita de detecție și limita de cuantificare au fost calculate din abaterea standard a zece probe blanc ($s = 0,00058$) și din panta dreptei de etalonare (b):

$$LOD = 3,3 \cdot s / b = 0,23 \mu\text{g/L} \quad LOQ = 10 \cdot s / b = 0,69 \mu\text{g/L} \quad (3.2)$$

Parametrii de validare pentru cele trei metale sunt prezentați în Tabelul 7. Toate îndeplinesc criteriile de acceptare: LOQ este mult sub valorile parametrice, repetabilitatea este sub 4%, iar recuperarea pe probe fortificate este între 96,0% și 101,2%.

Tabelul 7. Parametrii de validare a metodei

Parametrul	Pb	Cd	Ni	Criteriul de acceptare
Domeniul liniar (μg/L)	0–25	0–2	0–50	–
Coeficientul de determinare R^2	0,9996	0,9991	0,9993	$\geq 0,995$
LOD (μg/L)	0,23	0,03	0,45	Mult sub valoarea-limită
LOQ (μg/L)	0,69	0,09	1,36	$\leq 30\%$ din valoarea-limită
Repetabilitatea, RSD (%) ($n = 6$)	2,8	3,9	2,4	$\leq 10\%$
Recuperarea (%)	97,4	96,0	101,2	90–110%

Sursa: Date experimentale simulate; criteriile sunt alese de autor pentru exemplu.

3.3. Concentrațiile metalelor în probe

Concentrația de plumb a fost calculată din absorbanta medie a fiecărei probe, cu ecuația (3.1) (Tabelul 8). De exemplu, pentru proba P5: $c = (0,1014 - 0,0029) / 0,00837 = 11,77 \mu\text{g/L}$.

Tabelul 8. Absorbanța și concentrația de plumb în probe (media a trei determinări)

Punctul	Absorbanța medie	c Pb (μg/L)	AS (μg/L)
P1	0,0198	2,02	0,09
P2	0,0371	4,09	0,15
P3	0,0262	2,78	0,11
P4	0,0545	6,16	0,19
P5	0,1014	11,77	0,33
P6	0,0307	3,32	0,12

Notă. $c = (A - 0,0029) / 0,00837$; AS = abaterea standard a celor trei determinări.

Sursa: Date experimentale simulate pentru exemplu.

Rezultatele pentru toate cele trei metale sunt comparate cu valorile parametrice în Tabelul 9. Plumbul crește de la 2,02 μg/L la ieșirea din stația de tratare (P1) la 11,77 μg/L în clădirea veche (P5), singura probă peste valoarea de 10 μg/L (Figura 6).

Tabelul 9. Concentrațiile celor trei metale comparate cu valorile parametrice (μg/L)

Punctul	Pb	Cd	Ni	Conform?
P1	2,02	0,11	2,6	Da
P2	4,09	0,25	5,1	Da
P3	2,78	0,18	3,4	Da
P4	6,16	0,41	7,8	Da
P5	11,77	0,62	6,3	Nu (Pb peste 10 μg/L)
P6	3,32	0,21	4,2	Da
Valoare parametrică	10	5,0	20	–

Sursa: Date experimentale simulate; valori parametrice după [1].




Figura 6. Concentrația de plumb în punctele de prelevare, comparată cu valoarea parametrică (μg/L)

Sursa: Prelucrare proprie.

Raportate la valorile parametrice, cadmiul rămâne sub 13% din limită în toate punctele, iar nichelul sub 40%; doar plumbul se apropie de limită sau o depășește (Figura 7).




Figura 7. Concentrațiile exprimate ca procent din valoarea parametrică

Sursa: Prelucrare proprie.

3.4. Interpretarea rezultatelor

Sursa plumbului este instalația, nu apa tratată. Concentrația este mică la ieșirea din stația de tratare și în rețeaua din PEHD (2,02–4,09 $\mu\text{g/L}$) și crește doar în clădirile cu instalații interioare vechi (P4 și P5). Rezultatul este în acord cu studiile care arată că plumbul provine în principal din conductele și fittingurile interioare [3], [5].

Depășirea din P5 este sigură, nu o eroare de măsurare. Chiar dacă scădem dublul abaterii standard ($2 \times 0,33 \mu\text{g/L}$), concentrația rămâne peste 11 $\mu\text{g/L}$. În schimb, proba P4 (6,16 $\mu\text{g/L}$) este conformă astăzi, dar ar depăși valoarea de 5 $\mu\text{g/L}$ aplicabilă din 2036 [1].

Propunere: pentru clădirile vechi recomandăm o campanie de prelevare la prima curgere, după stagnarea apei peste noapte, care ar arăta expunerea maximă a consumatorilor.

Nu generaliza dincolo de date: o singură probă dintr-o clădire arată o problemă locală, nu „apa din oraș este toxică”. Spune clar câte probe ai și ce poți concluziona din ele.
Greșeală frecventă
20/05/2026 10:00

Concluzii

Metoda GFAAS a fost validată pentru Pb, Cd și Ni: dreapta de etalonare pentru plumb este liniară între 0 și 25 µg/L ($R^2 = 0,9996$), limitele de cuantificare sunt mult sub valorile parametrice, iar repetabilitatea și recuperarea îndeplinesc criteriile propuse.

În cinci din cele șase puncte, toate metalele sunt sub valorile parametrice. Singura neconformitate este plumbul din punctul P5 (11,77 µg/L), explicată cel mai probabil de instalația interioară veche.

Limitele lucrării: număr mic de probe, o singură campanie de prelevare și lipsa probelor la prima curgere. O continuare utilă ar fi monitorizarea sezonieră și confirmarea rezultatelor prin ICP-MS.

Concluziile reiau obiectivele din introducere și spun, pentru fiecare, ce ai obținut. Încheie cu limitele lucrării și cu direcții de continuare.
Ghid: licenta-disertatie-romania.co
Rolul secțiunii
20/05/2026 10:00

Bibliografie

- [1] Directiva (UE) 2020/2184 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2020 privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare). *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* **2020**, L 435.
- [2] Welz, B.; Sperling, M. *Atomic Absorption Spectrometry*, 3rd ed.; Wiley-VCH: Weinheim, **1999**.
- [3] Popa, A.; Ionescu, D. Plumbul în apa de la robinet: rolul instalațiilor interioare. *Rev. Chim. Anal. (exemplu)* **2022**, *14*, 101–112 (articol fictiv).
- [4] Georgescu, M. *Metode instrumentale în chimia analitică*; Editura Exemplu: București, **2020** (lucrare fictivă).
- [5] Dumitru, E.; Matei, R.; Stan, L. Metale grele în rețele urbane de distribuție a apei. *J. Water Anal. (exemplu)* **2023**, *8*, 45–58 (articol fictiv).
- [6] Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare.

La Chimie se folosește de obicei stilul ACS: trimiteri numerice [1] în text, sursele numerotate în ordinea primei citări. Directiva europeană, legea română și manualul lui Welz și Sperling sunt reale; celelalte surse sunt generice, inventate pentru exemplu.
Rolul secțiunii
20/05/2026 10:00

Anexa 1. Procedura de lucru pentru determinarea plumbului

1. Se prelevează 250 mL de apă în flacon de polietilenă spălat cu HNO_3 10%, după 2 minute de curgere.
2. Se acidulează proba cu HNO_3 65% până la $\text{pH} < 2$ și se păstrează la 4 °C.
3. Se prepară soluțiile etalon de 0, 5, 10, 15, 20 și 25 $\mu\text{g/L}$ Pb prin diluarea soluției de 1000 mg/L în HNO_3 0,2%.
4. Se măsoară etaloanele, apoi probele în trei replicare; după fiecare 10 probe se măsoară un etalon de control (10 $\mu\text{g/L}$, abatere admisă $\pm 10\%$).
5. Se măsoară zece probe blanc pentru calculul LOD și LOQ.
6. Se calculează concentrația cu ecuația dreptei de etalonare și se raportează media $\pm$ abaterea standard.

În anexă pui procedura detaliată (pas cu pas), datele brute și certificatele soluțiilor etalon. În text faci trimitere la anexă, nu repeți tot protocolul.
Rolul secțiunii
20/05/2026 10:00

Bonus: același paragraf, înainte și după corectare

Fragmentul de mai jos este scris intenționat cu greșelile pe care le întâlnim des în lucrările de Chimie. Dedesubt este aceeași idee după corectare.

Această pagină nu face parte din lucrare. Arată cum se schimbă un paragraf la o corectare atentă: aceeași idee, scrisă clar, cu sursă și în stil academic.

Ghid: licenta-disertatie-romania.com
Rolul secțiunii
20/05/2026 10:00

VARIANTA ÎNȚIALĂ

Am facut curba de calibrare si a iesit foarte bine ($R=0.99$). Plumbul a iesit mare in proba 5 deci apa din oras este toxica si nu ar trebui bauta. Rezultatele sunt in concordanta cu literatura de specialitate.

VARIANTA CORECTATĂ

Dreapta de etalonare pentru plumb este liniară în domeniul 0–25 $\mu\text{g/L}$ ($A = 0,00837 \cdot c + 0,0029$; $R^2 = 0,9996$), iar reziduurile nu prezintă o tendință sistematică (Tabelul 6). Concentrația de plumb în proba P5 ($11,77 \pm 0,33 \mu\text{g/L}$, $n = 3$) depășește valoarea parametrică de 10 $\mu\text{g/L}$ [1], în timp ce probele din rețea se situează între 2,02 și 4,09 $\mu\text{g/L}$. Diferența sugerează că sursa plumbului este instalația interioară a clădirii, în acord cu observațiile din [3].

CE AM CORECTAT

1. Am pus diacriticele și virgula zecimală, obligatorii în lucrare.
2. „A ieșit foarte bine” a devenit ecuația dreptei, domeniul de lucru, R^2 și verificarea reziduurilor.
3. Rezultatul are unitate de măsură, abatere standard și numărul de replicare.
4. Concluzia „apa din oraș este toxică” a fost restrânsă la ce arată datele: o singură probă, dintr-o clădire veche.
5. „În concordanță cu literatura” are acum o trimitere numerică precisă [3].

Vrei aceeași corectare pentru lucrarea ta? licenta-disertatie-romania.com/contact